

# e-Apo SP 起動手順書

第 1 版      2015年07月21日



# はじめに

本書は「e-Apo SP」についての起動手順を説明しています。  
本書をよくお読みになり十分に活用してください。また、お読みになった後も大切に保管してください。  
※本書中に使用している画面は参考画面です。お客様のお使いの機種により多少異なりますのでご了承ください。

◎日立メディカルコンピュータ株式会社


## Contents

<b>e-Apo SP の起動</b>	<b>2</b>
メインメニューから起動	2
会計画面から起動	2
<b>患者情報について</b>	<b>3</b>
e-Apo SP で初診前登録している患者さんが来院した場合	3
患者情報の更新	5
患者情報の削除	5

## e-Apo SP の起動


### ● メインメニューから起動

- 1 メインメニューから【アポイント】をクリックします。

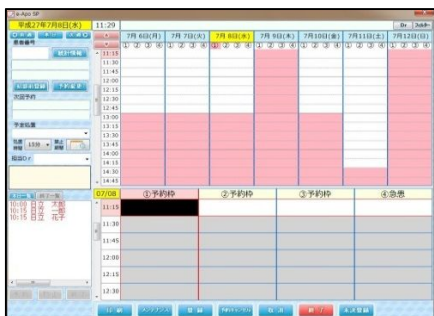


- 2 e-Apo SP が起動します。

### ● 会計画面から起動

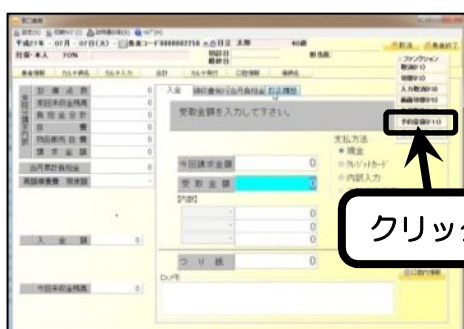

- 1 「会計」画面のファンクションから【予約登録(F11)】をクリックします。

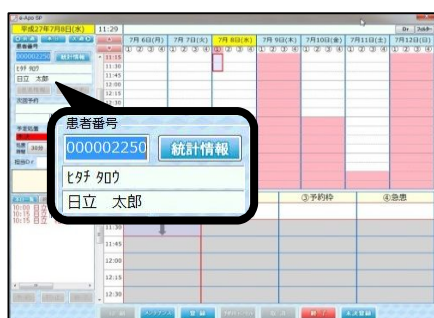

- 2 e-Apo SP が起動します。




「窓口」で参照中の患者さんを指定した状態で起動します。



#### 既に e-Apo SP が起動している場合

既に e-Apo SP が起動している場合、メッセージが表示され起動はされません。

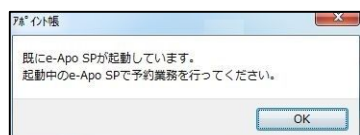

## 患者情報について

### e-Apo SP で初診前登録している患者さんが来院した場合

e-Apo SP で初診前登録している患者さんが来院した場合、歯科システムで患者情報を登録後、e-Apo SP で患者情報を一致させると、その患者さんが呼び出されて予約業務が行えるようになります。

＜患者情報を一致させる手順＞

1 「患者情報」画面で来院した患者さんの情報を入力し、【確定】→【患者終了】をクリックします。

2 メインメニューから【アポイント】をクリックします。



「会計」画面から e-Apo SP を起動すると、患者情報を一致させることができません。  
必ずメインメニューから e-Apo SP を起動させてください。

3 e-Apo SP が起動されます。

「本日一覧」から対象の患者さんを選択し、【来患】をクリックします。


クリック

4 「CSVインポート」画面が表示されます。


一致させたい患者番号を入力し、【実行】をクリックします。




患者番号がわからない場合は【×】をクリックしてください。

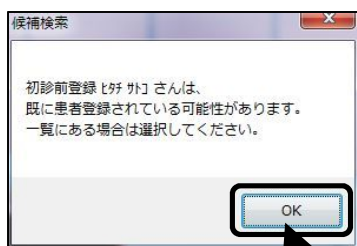

クリック

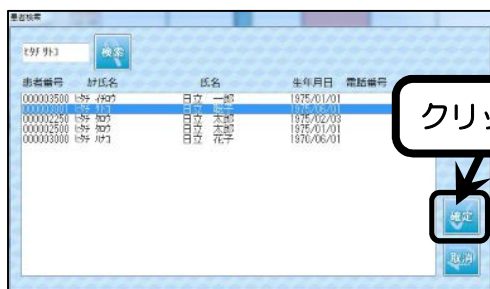

クリック

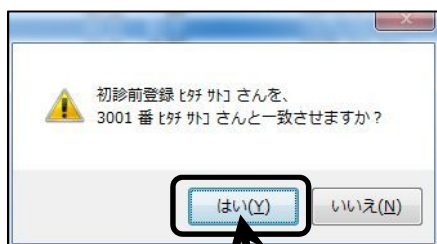

クリック



クリック

5 「候補検索」メッセージが表示されます。

【OK】をクリックします。



注意

カナ氏名の不一致などで、候補となる患者さんがいない場合、8 の画面が表示されます。

6 「患者検索」画面が表示されます。

一致させたい患者さんを選択し、【確定】をクリックします。

7 確認メッセージが表示されます。

一致させる患者さんを確認し、【はい】をクリックします。


8 「e-Apo SP 患者登録」画面が表示されます。

内容を確認し、【登録】をクリックします。



患者コードが入力されてない場合、一致させる対象の患者さんが選択されていない状態です。

【加検索】をクリックすると「患者検索」画面が表示されます。(6 の画面)

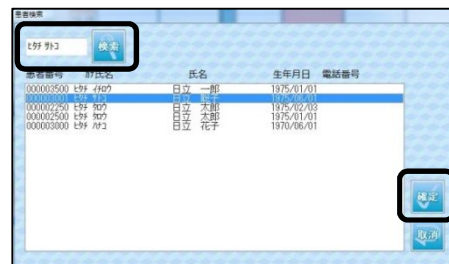

一致させたい患者さんの加を入力し、【検索】をクリックすると、患者さんの候補が表示されます。

一致させたい患者さんを選択し、【確定】をクリックすると「e-Apo SP 患者登録」画面へ反映されます。



9 対象の患者さんの患者コードが一致させた患者コードに変わります。

患者情報を一致させる手順は以上です。

## ● 患者情報の更新

歯科システムで患者情報を更新し【患者終了】をクリックすると、e-Apo SP で一致させている患者情報も更新されます。


## ● 患者情報の削除

歯科システムで患者を削除すると、e-Apo SP で一致させている患者も自動で削除されます。

# e-Apo SP 起動手順書

---

初 版 発 行 2015年 7月

発 行 所  日立メディカルコンピュータ株式会社

〒141-0031  
東京都品川区西五反田1丁目31番1号  
日本生命五反田ビル

落丁・乱丁本についてはお問い合わせください。  
本書の内容は将来予告無しに変更することがあります。  
本書の内容の一部または全部を日立メディカルコンピュータ株式会社に  
無断で転記あるいは複製することは禁じます。  
本書は内容について万全を期して制作致しましたが、万一記載に誤りや  
不完全な点がありましたら、弊社までご連絡ください。

Windowsは米国Microsoft社およびその他の国での商標もしくは登録商標です。  
その他本書に登場する会社名、製品名、プログラム名などは、それぞれに各社の商標もしくは登録商標です。  
なお、本文中には™および®マークなどは記載していません。  
また、このマニュアルに記載されている医療機関名、個人名等は架空のものであり、実在する医療機関、個人等とは一切関係ありません。