口臭測定器 BREATHRON Ⅱ

［操 作 手 順 表 ］

●下記の手順にしたがって操作してください。（ご使用の前に、必ず使用説明書をお読みください）

操作	表示	説明
マウスピース 装着		●保護キャップを取り外して、新しいマウスピースをアダプタに装着してください。 ! アルコール等の付着防止のため、マウスピースの装着部分（アダプタ）にはなるべく手を触れないように注意してください。
電源投入 ● POWER	good	●POWERスイッチを押してください。 自動的に自己診断を行い、正常であれば“good”が表示されます。 その後、約 30 秒間配管内部とセンサのクリーニングを行います。
⇩	○ STAND BY	クリーニングが終了すると STAND BY ランプが点滅から点灯に替わります。センサが安定するまでしばらくお待ちください。（約 2 分間）
セット マウスピース		●被験者にマウスピースを握るように持たせ、『マウスピースの先端を軽く噛むようにして口を閉じ、楽に鼻で呼吸をしてください。』と指示してください。 ! 口腔内の奥に入れすぎないようにしてください。 ! 唾液吸引を防ぐために、下を向かないように指示してください。
測定開始 ○ START ⇩	30 ⇩ 0	START ランプが点滅すると、測定が可能です。 ●START スイッチを押してください。 測定を開始し、呼気を 30 秒間自動吸引します。 デジタルパネルに、測定終了までの残り時間が表示されます。
測定終了	NORMAL 100	VSC 濃度および口臭の強さのランクが表示されます。※ランク分けの範囲は変更可能です（使用説明書を参照）。 ●マウスピースを口から外してください。

ランク	指示値（ppb）
NORMAL	0～250
MILD	251～600
MODERATE	601～1500
SEVERE	1501～3000

印刷	印刷不要	
○ RESET PRINT	○ START	RESET/ PRINT ランプが点滅すると、印刷が可能です。 ●印刷をする場合は、RESET/ PRINT スイッチを押してください。 ●印刷が不要な場合は、START スイッチを押してください。 上記の操作で自動的にクリーニング・スタンバイを行います。所要時間は前回の測定結果に応じて自動的に設定されます。（約 2～4 分間））
マウスピース 交換		●続けて測定をする場合は、マウスピースを新しいものと交換してください。 ●測定を終了する場合は、保護キャップに付け替えてください。 ! アルコール等の付着防止のため、マウスピースの装着部分（アダプタ）にはなるべく手を触れないように注意してください。
測定開始待ち		START ランプと RESET/ PRINT ランプが同時に点滅すると、次の測定が可能です。
再印刷 ○ RESET PRINT	測定開始 ○ START	●前回の結果をもう一度印刷する場合は、RESET/ PRINT スイッチを押してください。（次の測定を行うまでは複数枚の印刷が可能です） ●次の測定を行う場合は START スイッチを押してください。 ●測定を終了する場合は POWER スイッチを押して電源を切ってください。 ! 精度良い測定のために、強い口臭を測定したあとは、次回測定まで 10 分程度時間を空けるようにしてください。

〈使用しない時の保管方法について〉

本器は電源投入後速やかに測定が開始できるように、電源スイッチとは無関係に、常にセンサに電力が供給されるよう設計されています。**使用しない時でも、電源コードはコンセントに接続したままにしてください。** 長期間電源コードが抜かれていた場合は、電源コードを接続してから約 20 分程度お待ちになってから測定をしてください。

口臭測定器 **BREATHTRON Ⅱ**

口臭検査の受け方

①	**先端を 2cm ほど残して 握るように持ちます。** 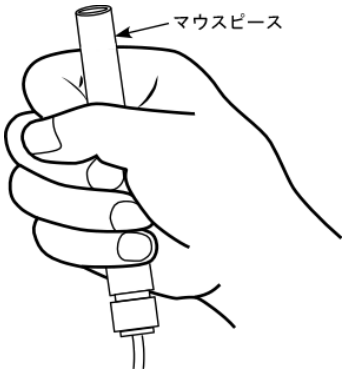
②	**マウスピースの先端を軽く噛むようにします。**
③	**唇とマウスピースの隙間を指の付け根で ふさぐようにします。**
④	**リラックスして少し上を向いて鼻から息をして ください。（検査は 30 秒で終わります）**

唾液が吸引されないよう注意してください

下を向くと唾液が吸引される恐れがあります

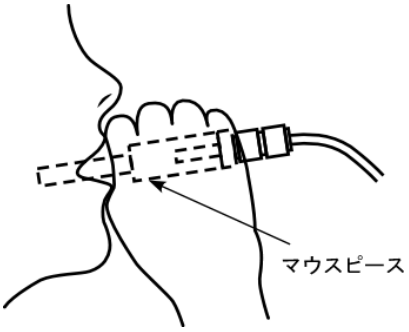

○ 良い例：少し上を向く

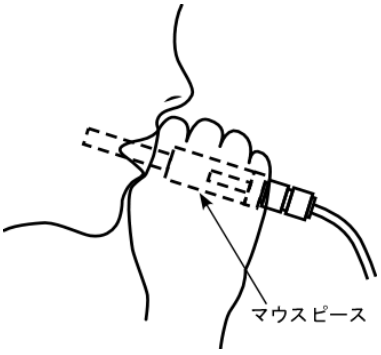

× 悪い例：下を向く